
B20423

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

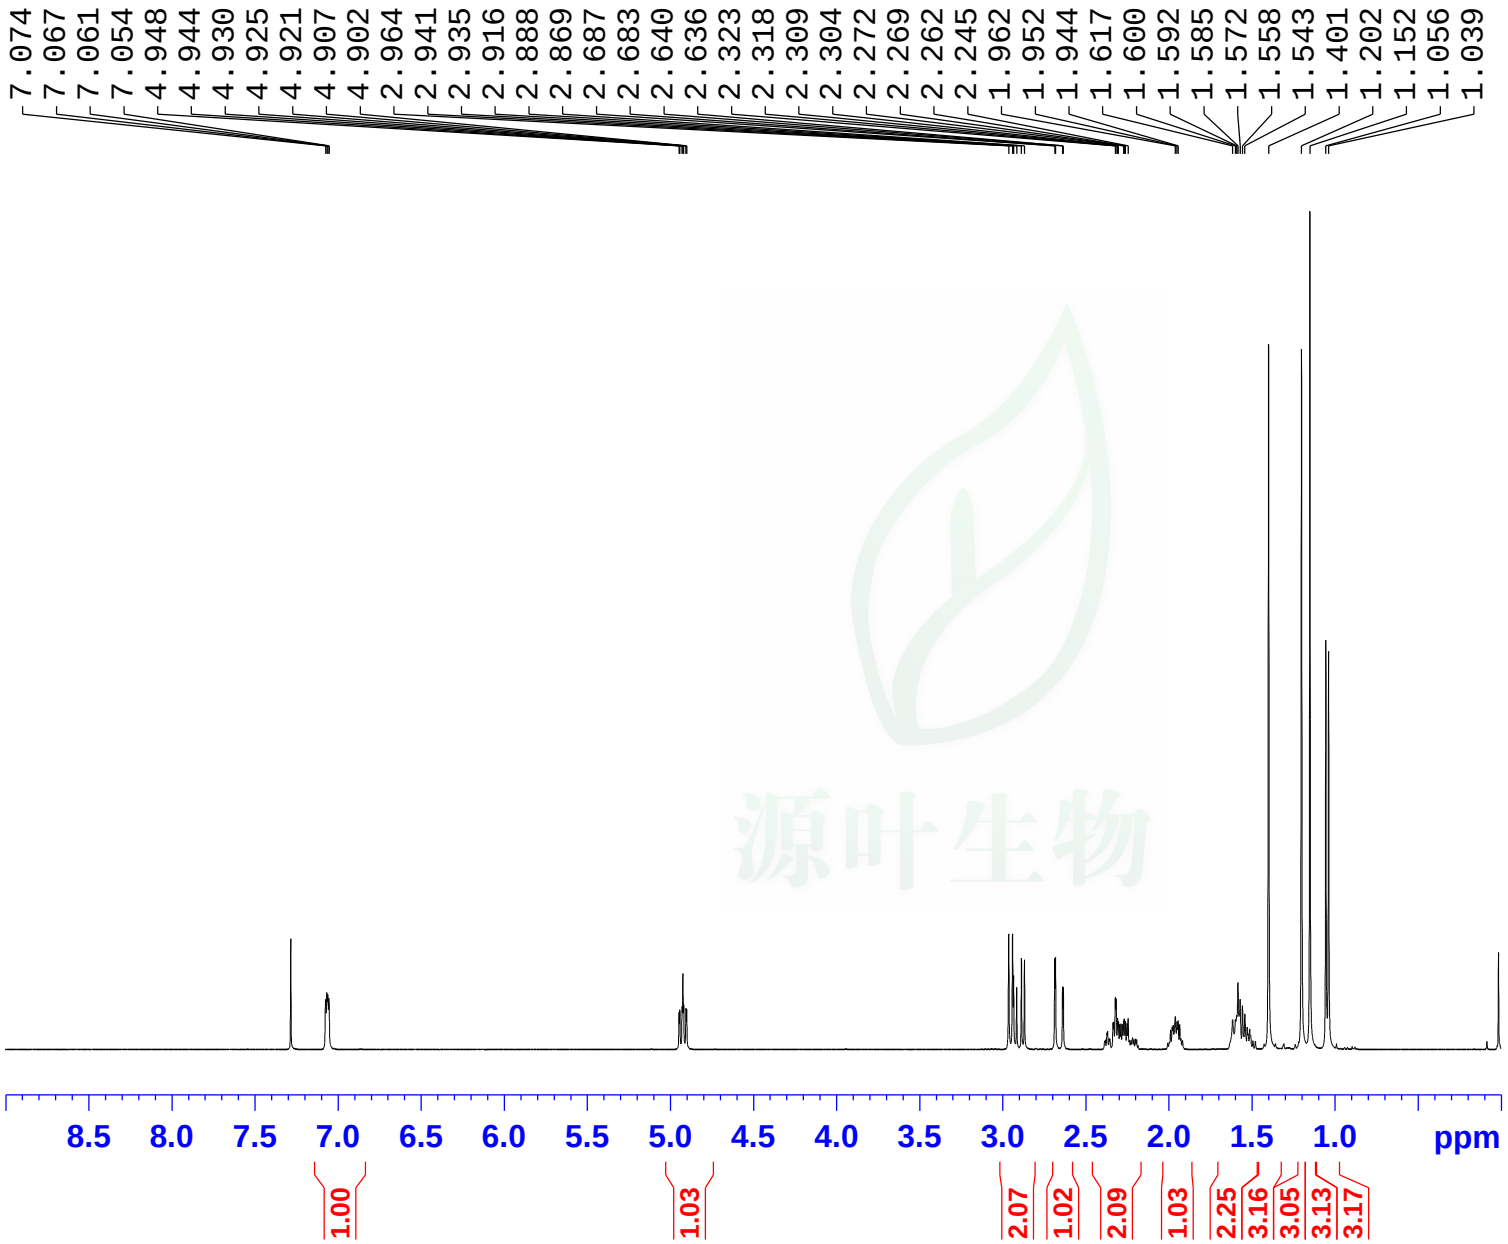


```
Current Data Parameters
NAME                  B20423
EXPNO                     10
PROCNO                     1

F2 - Acquisition Parameters
Date_              20180118
Time                  13.02
INSTRUM               spect
PROBHD    5 mm PABBO BB-
PULPROG                zg30
TD                    65536
SOLVENT               CDCl3
NS                       16
DS                        2
SWH                8223.685 Hz
FIDRES             0.125483 Hz
AQ                 3.9846387 sec
RG                     107.3
DW                    60.800 usec
DE                     6.50 usec
TE                    299.9 K
D1              1.00000000 sec

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                      1H
P1                    12.00 usec
PLW1           22.00000000 W
SFO1           400.1324710 MHz

F2 - Processing parameters
SI                    65536
SF             400.1300000 MHz
WDW                      EM
SSB       0
LB                     0.30 Hz
GB        0
PC                     1.00
```