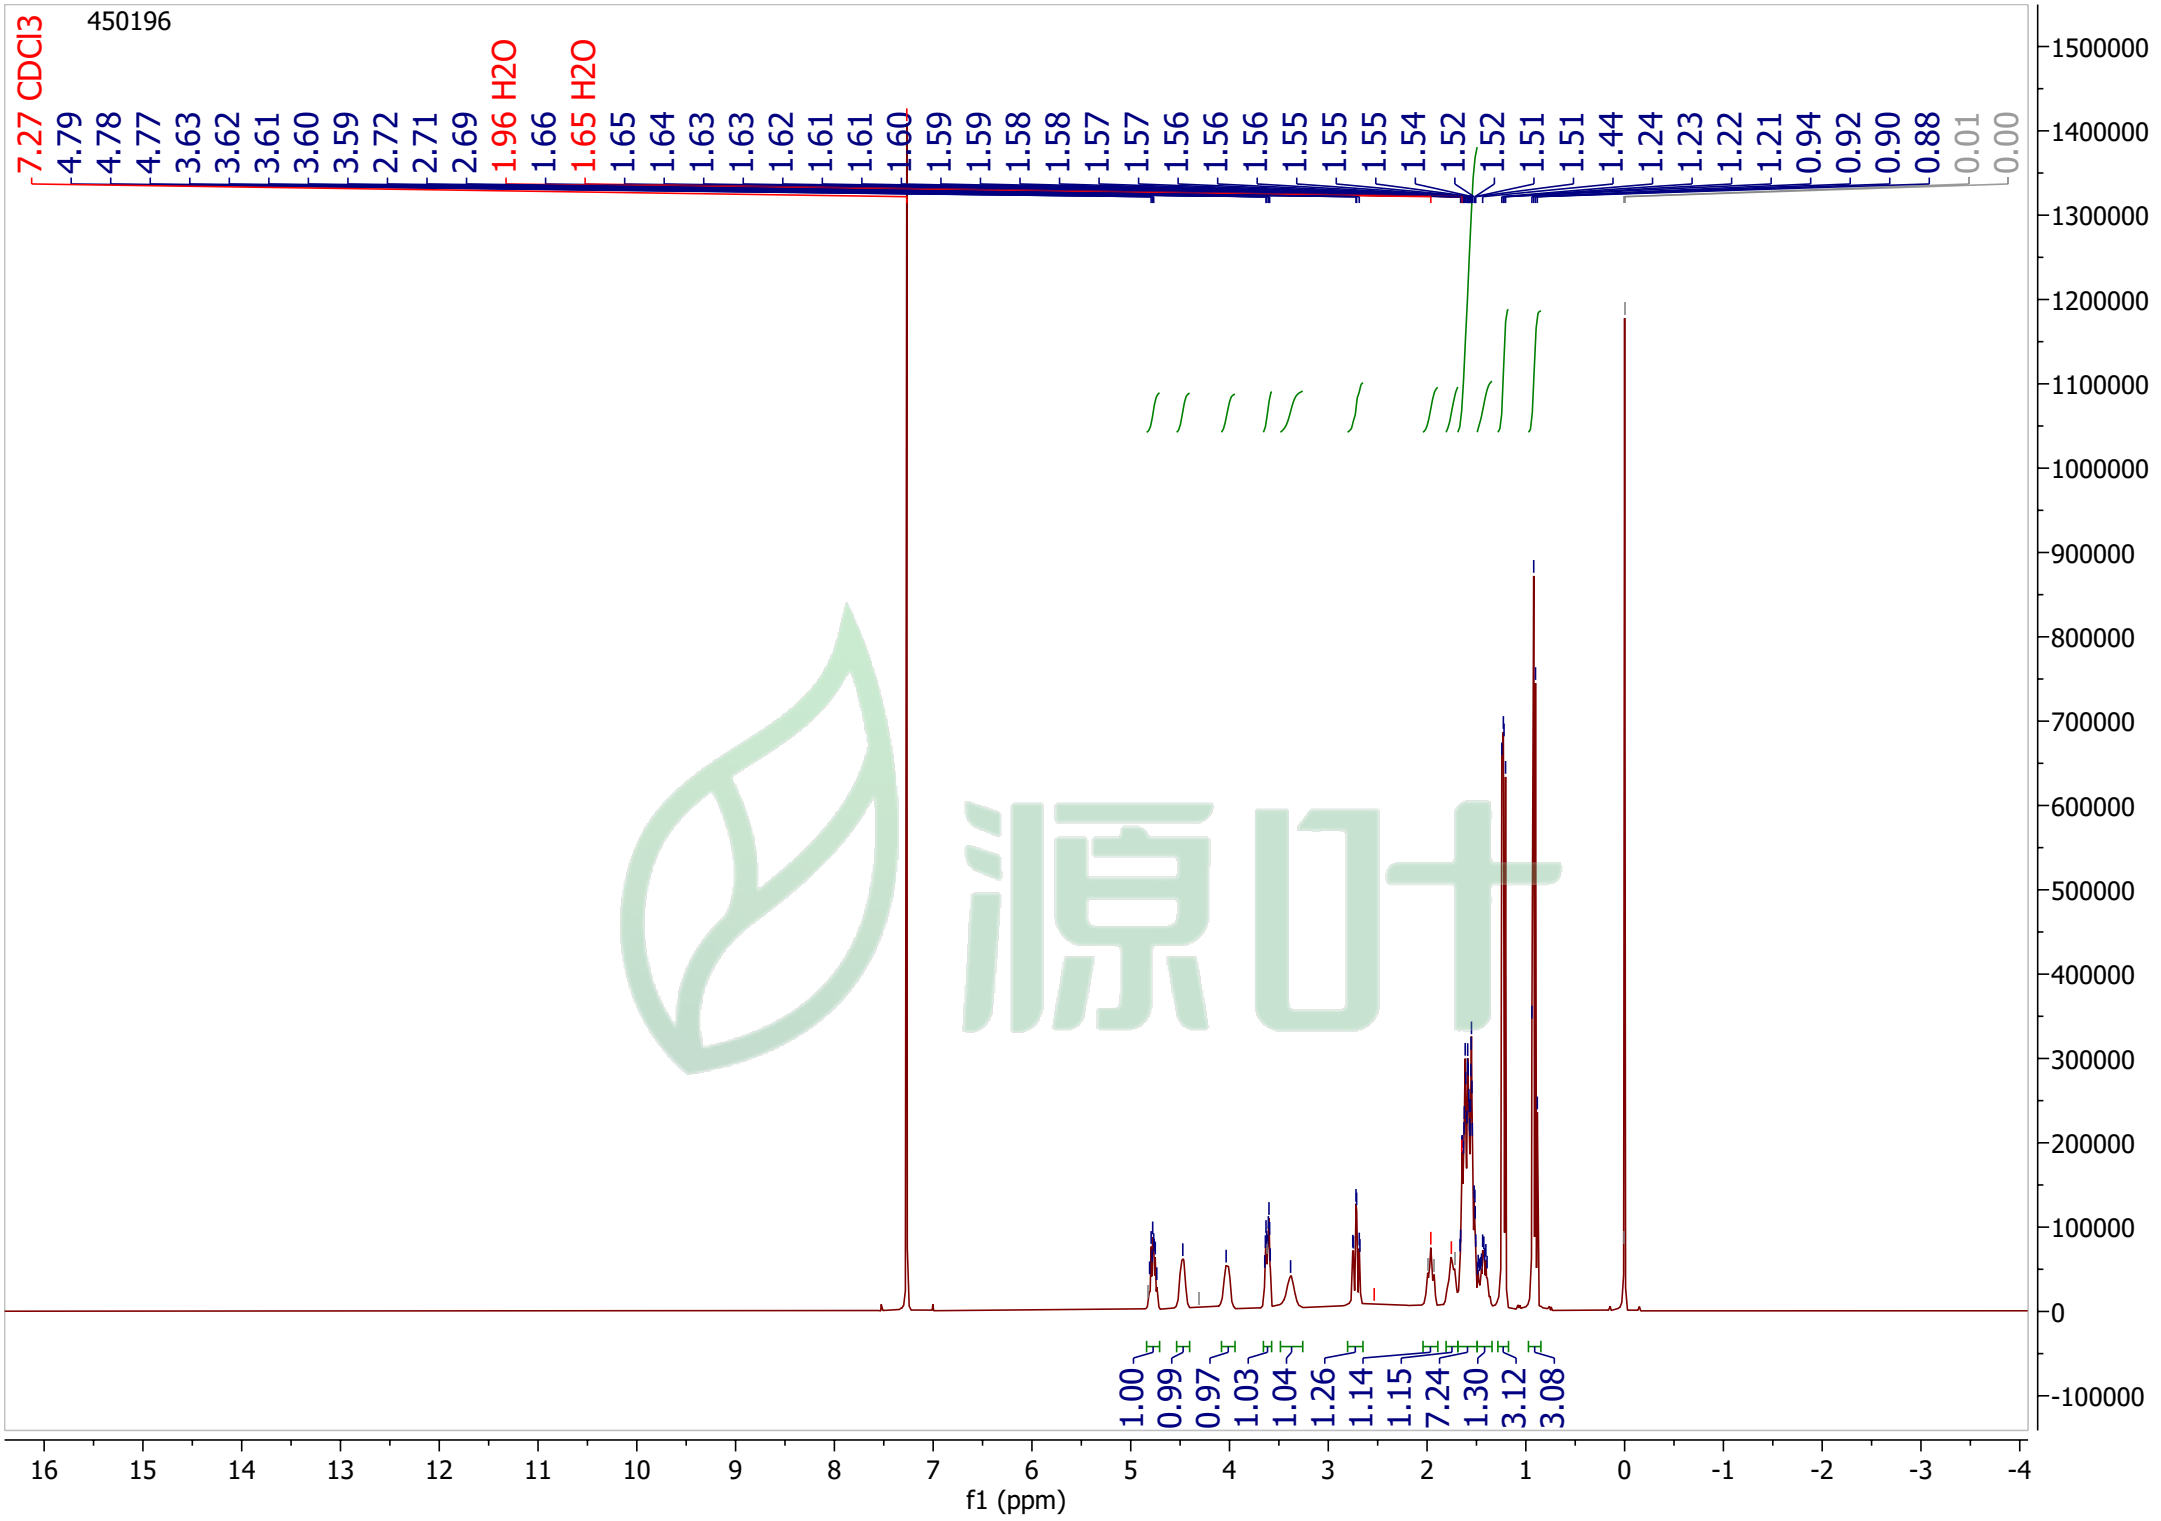

450196
7.27 CDCl3
4.79
4.78
4.77
3.63
3.62
3.61
3.60
3.59
2.72
2.71
2.69
1.96 H2O
1.66
1.65 H2O
1.65
1.64
1.63
1.63
1.62
1.61
1.61
1.60
1.59
1.59
1.58
1.58
1.57
1.57
1.56
1.56
1.56
1.55
1.55
1.55
1.54
1.52
1.52
1.51
1.51
1.44
1.24
1.23
1.22
1.21
0.94
0.92
0.90
0.88
0.01
0.00
1.00
0.99
0.97
1.03
1.04
1.26
1.14
1.15
7.24
1.30
3.12
3.08
f1 (ppm)