

脂质氧化（MDA）检测试剂盒


产品编号	产品名称	规格
R33137-500T	脂质氧化（MDA）检测试剂盒	500T

产品简介:

脂质氧化(MDA)检测试剂盒采用一种基于丙二醛（Malondialdehyde, MDA）和硫代巴比妥酸（thiobarbituric acid, TBA）反应产生红色产物的显色反应，随后通过比色法用于对血浆、血清、尿液、动植物组织或细胞裂解液中 MDA 进行定量检测，广泛用于脂质氧化（lipid peroxidation）水平检测的试剂盒。

MDA 是一种生物体脂质氧化的天然产物。动物或植物细胞发生氧化应激（oxidative stress）时，会发生脂质氧化。一些脂肪酸氧化后逐渐分解为一系列复杂的化合物，其中包括 MDA。此时通过检测 MDA 的水平即可检测脂质氧化的水平，因此 MDA 的测定被广泛用作脂质氧化的指标。生物体内的一些其它生化反应也会产生 MDA，例如血栓素合成酶（thromboxane synthase）也可以催化产生，但只要在测定时设置适当对照即可观察到脂质氧化水平的变化。

丙二醛在较高温度及酸性环境中可与 TBA 发生反应，形成红色的 MDA-TBA 加合物，反应原理如下：

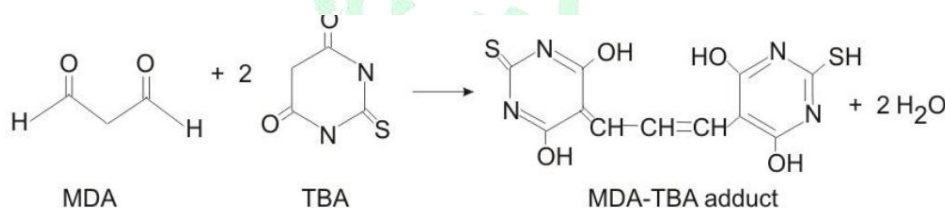

MDA-TBA 加合物在 535nm 处有最大吸收，据此可以通过比色法进行检测。另外，MDA-TBA 加合物也可以在 535nm 被激发产生最大发射波长 553nm，据此也可以进行荧光检测。

本试剂盒中采用了特殊的抗氧化剂，可以有效地抑制样品在检测过程中产生新的 MDA，并且可以把部分 MDA 天然形成的聚丙烯二醛分解成 MDA 使检测更加准确。

本试剂盒可以检测低至 1μM 的 MDA，也可检测高达 200μM 的 MDA（参考

图1)。血浆、血清样品中的MDA含量通常在约2-4 μ M，尿液中的MDA含量通常在约5-30 μ M，在本试剂盒的检测范围内，可以直接用本试剂盒检测血浆、血清、尿液样品等。

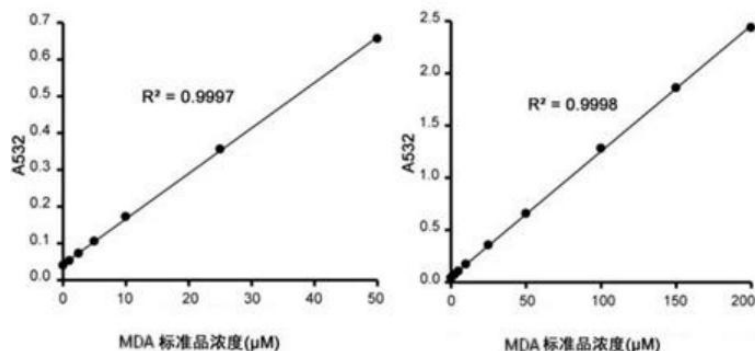


图1. 不同浓度标准品使用本试剂盒的检测效果图。实测数据会因检测仪器等的不同而存在差异，图中数据仅供参考。

产品组成:

组分	R33137-500T
TBA	125 mg
TBA 稀释液	75 ml
抗氧化剂	1.5 ml
标准品 (1mM)	1 ml

使用方法:

一.样品的准备:

(a) 血浆、血清或尿液样品制备后可以直接用于MDA测定。

(b) 组织或细胞可以使用PBS或裂解液进行匀浆或裂解。对于组织，组织重量占匀浆液或裂解液的比例为10%；对于细胞，每 1×10^6 的细胞使用0.1ml裂解液或匀浆液。匀浆或裂解后，10,000g-12,000g离心10分钟取上清用于后续测定。对于一些特殊样品，离心不能获得澄清的上清溶液的，可以使用0.2 μ m孔径的过滤器过滤以获得澄清的样品溶液。匀浆或裂解等样品制备步骤建议在冰浴或4 $^{\circ}$ C进行操作。样品准备完毕后建议用BCA蛋白浓度测



定试剂盒测定蛋白浓度，便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 MDA 含量。

(c) 本试剂盒对于样品中的常见化学成分的兼容性参考下表：

试剂类别	化学成分	试剂类别	化学成分	
缓冲试剂	Borate ($\leq 50\text{mM}$)	抑制剂/螯合剂	Antipain ($\leq 100\text{ }\mu\text{ g/ml}$)	
	HEPES ($\leq 100\text{mM}$)		Chymostatin ($\leq 10\text{ }\mu\text{ g/ml}$)	
	Phosphate ($\leq 100\text{mM}$)		Leupeptin ($\leq 10\text{ }\mu\text{ g/ml}$)	
	Tris ($\leq 25\text{mM}$)		PMSF ($\leq 200\text{ }\mu\text{ M}$)	
去垢剂	CHAPS ($\leq 1\%$)		Trypsin ($\leq 10\text{ }\mu\text{ g/ml}$)	
	Triton X- 100 ($\leq 1\%$)		EDTA ($\leq 1\text{mM}$)	
	Tween 20 ($\leq 1\%$)		EGTA($\leq 1\text{mM}$)	
其它试剂	Sucrose (250mM)(不建议使用)			
	Glycerol ($\leq 10\%$)			

二.试剂盒的准备工作：

(a) TBA 储存液的配制：称取适量 TBA，用 TBA 配制液配制成浓度为 0.37% 的 TBA 储存液。例如 18.5mg TBA 用 5ml TBA 配制液配制，或者 25mg TBA 用 6.76ml TBA 配制液配制，最终浓度即为 0.37%。TBA 配制液需完全溶解后再使用，可以加热到 70℃ 以促进溶解。TBA 储存液较难溶解，需加热到 70℃，并通过剧烈涡旋振荡以促进溶解。配制好的 TBA 储存液室温避光保存，至少 3 个月内有效。

(b) MDA 检测工作液的配制：根据待测定的样品数(含对照)，参考下表在临检测前新鲜配制适量的 MDA 检测工作液。

检测样品数	1	10	20	50
TBA 稀释液	150 μl	1500 μl	3000 μl	7500 μl
TBA 储存液	50 μl	500 μl	1000 μl	2500 μl
抗氧化剂	3 μl	30 μl	60 μl	150 μl

注：MDA 检测工作液较难溶解，可以 70℃ 加热，并剧烈涡旋振荡以促进溶解。也可以通过超声处理以促进溶解。配制好的 MDA 检测工作液必须当天使用。



(c) 标准品的稀释: 取适量标准品用蒸馏水稀释至 1、2、5、10、20、50 μM , 用于后续制作标准曲线。如果样品中 MDA 的浓度很高, 可以增加 100、150 和 200 μM 的标准品浓度。

三.样品测定:

(a) 在离心管或其它适当容器内加入 100 μl 匀浆液、裂解液或 PBS 等适当溶液作为空白对照, 加入 100 μl 上述不同浓度标准品用于制作标准曲线, 加入 100 μl 样品用于测定; 随后加入 0.2ml MDA 检测工作液。可参考下表设置检测反应体系:

	样品	标准品	空白对照
待测样品	100 μl	-	-
标准品	-	100 μl	-
MDA 检测工作液	200 μl	200 μl	200 μl
匀浆液、裂解液或 PBS	-	-	100 μl

(b) 混匀后, 100 $^{\circ}\text{C}$ 或沸水浴加热 15 分钟。加热时务必注意避免液体暴沸溅出。如果使用加热块进行加热注意用重物压紧离心管盖; 如果使用沸水浴, 则需使用可把盖子锁死的离心管或螺旋盖离心管, 或用封口膜封住离心管口, 用针头刺一小孔。最方便和准确的加热方法是使用带有热盖并可以加热 0.5ml PCR 管的 PCR 仪。

(c) 水浴冷却至室温, 1000g 室温离心 10 分钟。取 200 μl 上清加入到 96 孔板中, 随后用酶标仪在 532nm 测定吸光度。如果不方便测定 532nm 的吸光度, 也可以测定 530-540nm 之间的吸光度。可以设定 450nm 为参考波长进行双波长测定。

(d) MDA 含量的计算: 对于血浆、血清或尿液等样品可以直接根据标准曲线计算获得 MDA 的摩尔浓度, 对于细胞、或组织样品, 计算出样品溶液中的 MDA 含量后, 可以通过单位重量的蛋白含量或组织重量等来表示最初样品中的 MDA 含量, 例如 $\mu\text{mol}/\text{mg}$ 蛋白或 $\mu\text{mol}/\text{mg}$ 组织。

注意事项:

1、如果没有检测到 MDA, 可能样品中 MDA 浓度过低, 在检测组织或细胞的 MDA 时, 请使用更多的组织或细胞, 不要稀释样品。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

2、醛以及较高浓度的可溶性糖（例如 250mM 蔗糖/葡萄糖）对反应有干扰，可溶性糖与 TBA 显色反应的产物在 532nm 也有吸收（最大吸收在 450nm）。如果可溶性糖对测定有干扰，可以通过测定 450nm 作为参考波长进行双波长测定，消除其干扰。

3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

-20℃避光保存，有效期一年。

